



LOYIHALAR VA XARIDLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH MARKAZI

2026-yil 14 may № 01-18/1-1261 100000, Toshkent, Niyozbek yo'li ko'chasi, 1-uy



O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
"Xaridlar markazi" DM ga

Tender bo'yicha xarid qilish hujjatlari loyihasini o'rganish yakuniga ko'ra XULOSA

Xarid predmeti	Respublika tibbiyot muassasalari uchun tibbiy jihoz (MSKT - 4 dona)
Ariza raqami va sanasi	2026-yil 22-apreldagi 26-05-849-son ariza (expertcenter.uz saytidagi ro'yxat raqami: 64719)
Buyurtmachi	O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi
Xaridni amalga oshirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrdagi "2025-2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-454-sonli qarori, Sog'liqni saqlash vazirligining 2026-yil 26-fevraldagi 04-25/5214-son ko'rsatma xati va 21-apreldagi 04-25/10485-son xati
Moliyalashtirish manbai	Budjet mablag'lari
Buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx	18 548 203 571,43 so'm (QQS siz); 20 773 988 000,00 so'm (QQS bilan)
Ko'rib chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-yanvardagi PQ-3464-son va 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-son qarorlari, "Loyihalar va xaridlar samaradorligini oshirish markazi" DM va "Xaridlar markazi" DM o'rtasidagi 2025-yil 26-maydagi ЭКс-2 750-son shartnoma
To'lov miqdori va sanasi	2 077 398,8 so'm QQS bilan, 2026-yil 29-aprel

81210000

“Loyihalar va xaridlar samaradorligini oshirish markazi” DM (keyingi o‘rinlarda – Markaz) respublika tibbiyot muassasalari uchun tibbiy jihoz xarid qilish bo‘yicha tender hujjatlari loyihasini o‘rganish natijalariga ko‘ra quyidagilarni ma’lum qiladi.

3-jadvalning 1.3-bandidan “MDR”, “yoki FDA” so‘zlari chiqarib tashlanishi lozim.

Texnik topshiriq bo‘yicha

Xarid qilish tartib-taomilida potensial ishtirokchilar (ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar) doirasini kengaytirish maqsadida, texnik topshiriqning 5-bandida quyidagilarni inobatga olish lozim:

- “масса гентри в сборе, кг” qatorida “не более 880” so‘zlarini “указать” so‘zlariga almashtirilishi;

- “минимальное время оборота блока «трубка-детектор» за один полный оборот (360 градусов), сек” qatorida “не более не более 0,98 сек.” so‘zlarini “не более 1 сек.” so‘zlariga almashtirilishi;

- “размер фокусного пятна - не более 0,8 x 0,6 мм” qatori “рентгеновская трубка должна обеспечивать получение диагностических изображений высокого пространственного разрешения - соответствие” tahrirda bayon etilishi;

- “максимальная длительность спирального сканирования - не менее 120 сек.” qatori “система должна обеспечивать выполнение непрерывного спирального сканирования, достаточного для проведения стандартных диагностических исследований – соответствие” mazmunida bayon etilishi;

- “интерфейс пользователя, идентичный консоли оператора закупаемого томографа - наличие” qatori “пользовательский интерфейс рабочей станции должен быть унифицирован с консолью оператора томографа по основным принципам управления и обработки изображений – соответствие” tahrirda bayon etilishi lozim.

Narx qismi bo‘yicha

Asosiy narx shartlari jadvalida:

- 1-banddan “rezidentlar uchun” so‘zlari chiqarib tashlanishi;
- 1.1-band (norezidentlar uchun boshlang‘ich narx) chiqarib tashlanishi;
- 7-band “Elektron tender to‘g‘risida ma’lumot” jadvalining “Yetkazib berish/xizmat ko‘rsatish muddatlari” qatori bilan muvofiqlashtirilishi lozim.

Markaz tomonidan bozor konyunkturasini o‘rganish natijalariga ko‘ra, xaridning boshlang‘ich umumiy narxini QQS bilan 14 mlrd so‘mdan (QQS siz 12,5 mlrd so‘mdan) oshmagan holda belgilash maqsadga muvofiq.

O‘z navbatida, xarid komissiyasi tomonidan kelishilgan boshlang‘ich narx xaridning eng yuqori narxi hisoblanadi, yakuniy narx xarid jarayonlari natijalariga ko‘ra aniqlanadi.

Xorijiy ishtirokchilar uchun shartnoma loyihasi bo‘yicha

“2025-yil” so‘zlari “2026-yil” so‘zlariga almashirilsin.

3.7-band chiqarib tashlanishi lozim.

Tender o'tkazish haqidagi e'lonning matni bo'yicha

Portalda va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish uchun tender o'tkazish haqidagi e'lon matni xarid qilish bo'yicha tender hujjatlari talablari bilan muvofiqlashtirilishi, shu bilan birga 4-bandda:

- *"qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik jarayonida bo'lmashlik"* so'zlarini *"o'ziga nisbatan joriy etilgan to'lovga qobiliyatsizlik tartib-taomillarining mavjud emasligi"* so'zlariga almashtirilishi;


- *"nohalol ijrochilarning"* so'zlari *"Insofsiz ijrochilarning"* so'zlariga almashtirilishi;

- *"tenderlar e'lon qilinishidan kamida 6 oy oldin tashkil topgan bo'lishi"* so'zlari chiqarib tashlanishi yoki xarid qilish hujjatlarining tegishli bandlarida nazarda tutilishi lozim.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat xaridiga doir tender bo'yicha xarid qilish hujjatlarini va texnik topshiriqlarni kompleks ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq ekspertiza uchun taqdim etilgan tender hujjatlari va texnik topshiriqning to'liqligi hamda ishonchliligi uchun davlat buyurtmachisi mas'uldir.


Yuqoridagilarni inobatga olib, buyurtmachi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etishi, moliyalashtirish manbalari va hajmlari tasdiqlangan taqdirda, davlat xaridlarini budget mablag'laridan oqilona va samarali foydalangan holda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq o'rnatilgan tartibda, davlat xaridlarini bajarish uchun talabgorlarni xarid jarayonlariga keng jalb qilgan holda xaridni amalga oshirish lozim.

Direktor




N. Sharipov

Direktor o'rinbosari



A. Dalxanov

Boshqarma boshlig'i

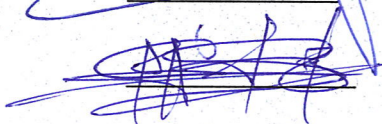


R. Saydaqulov

Boshqarma boshlig'i
o'rinbosari



T. Karimova

Bo'lim boshlig'i



S. Yusupov

Bo'lim boshlig'i
o'rinbosari



D. Raximov



LOYIHALAR VA XARIDLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH MARKAZI

2026-yil 11 iyun №01-18/1-1870

100000, Toshkent, Niyozbek yo'li ko'chasi, 1-uy

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
"Xaridlar markazi" DM ga

2026-yil 21-maydagi
26-05-1103-son xatga javoban

"Loyihalar va xaridlar samadorligini oshirish markazi" DM (keyingi o'rinlarda – Markaz) respublika tibbiyot muassasalari uchun 4 dona MSKT tibbiy jihoz xarid qilish bo'yicha tender hujjatlari yuzasidan Markazning 2026-yilning 14-maydagi 01-18/1-1261-son xulosasi (expertcenter.uz saytidagi ro'yxat raqami 64719) bo'yicha xatingizni va unga ilova qilingan izohlarni ko'rib chiqib, quyidagilarni ma'lum qiladi.

Texnik topshiriqdagi *"размер фокусного пятна - не более 0,8 x 0,6 мм"* tahriridagi talab texnik jihatdan noaniq bayon etilgan (ushbu parametr kichik fokus dog'iga yoki katta fokus dog'iga taalluqli ekanligi ko'rsatilmagan). Kompyuter tomografiyasida qo'llaniladigan rentgen trubkalarida fokus dog'i o'lchamlari ishlab chiqaruvchining texnik yechimiga qarab kichik va katta fokus dog'i bo'yicha alohida ko'rsatilishi mumkin. Bundan tashqari, *"0,8 x 0,6 мм"* qiymatida o'lchamlarning qaysi tartibda va qaysi o'qlar bo'yicha berilgani aniqlashtirilmagan.

Shu sababli, nomlanishlar va atamalarni yagona shaklda qo'llash hamda ularning turli ma'nolarda talqin qilinishiga yo'l qo'ymaslik hamda ishtirokchilarning takliflarini obyektiv baholash maqsadida ushbu talabni quyidagi tahrirda bayon etish maqsadga muvofiq *"рентгеновская трубка должна обеспечивать получение диагностических изображений высокого пространственного разрешения и надлежащего диагностического качества - соответствие"*. Bunda ishtirokchi o'z taklifida rentgen trubkasining fokus dog'i o'lchamlarini ishlab chiqaruvchining texnik hujjatlariga muvofiq ko'rsatadi.

"Максимальная длительность спирального сканирования - не менее 120 сек." tahriridagi parametr turli ishlab chiqaruvchilarning texnik yechimidan kelib chiqib belgilanadi. Shu munosabat bilan, mazkur talab funksional tahrirda (*"Система должна обеспечивать выполнение спирального сканирования, достаточного для проведения стандартных диагностических исследований в соответствии с клиническим назначением оборудования - соответствие"*) yoki quyidagicha *"Максимальная длительность спирального сканирования - не менее 100 сек."* bayon etilishi maqsadga muvofiq.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, buyurtmachi xarid tartib-taomillarini O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirishi lozim.

Direktor



N. Sharipov

Ijrochi: D.Raximov
tel: +998 (71) 207-02-82